Guia de Vocabulário MedCore.

Como fazer um teste à glucose com o MedCore Care

1. Lavar as mãos e secar muito bem.
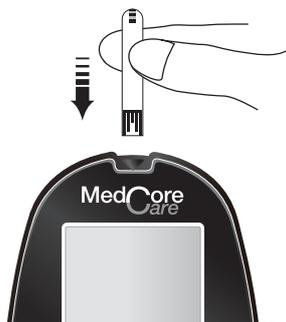
2. Colocar a vareta de teste na abertura no topo do medidor e fechar a tampa imediatamente.

3. Desaparafusar a tampa da caneta de testes e colocar a lanceta incluída no saco do medidor; rodar a tampa da lanceta para a remover *(proteção de esterilização)*, aparafusar novamente a tampa da caneta e rodar até obter a profundidade de penetração da agulha que pretende.

4. Aguardar até que apareça no visor uma gota a piscar e tirar uma amostra de sangue com a caneta de testes; limpar a primeira gota de sangue.

5. Colocar a extremidade da vareta de testes na gota de sangue e deixe que o sangue seja absorvido pela área do reagente.

6. O resultado é apresentado no visor após 6 segundos.

No caso de pretender guardar os resultados do teste como *"antes da refeição/depois da refeição"*
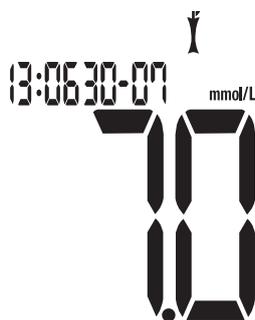
1. Se pretende guardar os resultados com marcação de refeições, deve premir ▲ até aparecer uma maçã com dentadas como "depois da refeição",

2. ou premir ▲ novamente para não ser apresentada nenhuma das marcações acima e assim não marcar um resultado
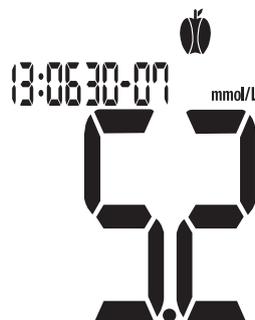
3. ou premir ▲ novamente até aparecer uma maça sem dentadas para marcar *"antes da refeição"*

4. Premir ⏻ para confirmar. Remover a vareta de testes, e de seguida descartar no recipiente indicado. O último resultado fica guardado.

Medcore Sweden AB, Finlandsgatan 62, Box 6065, SE - 164 06 Kista,
Tel: +46 (0)8 631 08 30, Fax: +46 (0)8 631 08 40, info@medcore.se, www.medcore.se

1. Premir ⏻ durante cerca de 2-3 seg., *(aparece ”mem” no canto direito superior do visor)* para ligar o medidor e o visor LCD acende-se com o último resultado de teste

2. Para voltar atrás na memória premir ▲. Premir ▼ para voltar.

3. Para visualizar os valores médios de 1 dia, 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias, premir ⏻ e de seguida ▲, para ver estes resultados.

4. Premir ⏻ para voltar ao último resultado.

Guia de Vocabulário MedCore.

Definir hora, data, hipo, hiper e alarme do MedCore Care

FunC

1. Premir ⏻ *(Ligar/Desligar)* até aparecer *"FunC"* no visor. A data e a hora ficam a piscar, para alterar premir ⏻ mais uma vez

13:06 30-07

2. Com as setas ▲/▼ *(cima/baixo)* é possível alterar o mês, dia, ano, hora e minutos, e com ⏻ navega para a frente no menu. Quandos todos os números de *"data, hora"* ficam novamente a piscar, premir ▲ para Ligar/Desligar o som. O medidor está ajustado em Ligado na entrega. […]

3. Premir ▲ para aceder a ajustamento do som Ligar/Desligar. O medidor está ajustado em Ligado na entrega, premir em ⏻ para alterar com as setas ▲/▼ e premir ⏻ para confirmar.
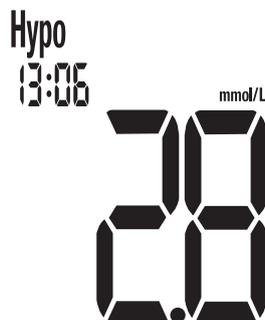
4. Premir ▲ para aceder ao ajustamento do valor de Hipoglicímia, ficando *"Hypo"* a piscar; na entrega o valor de hipoglicímia está definido para 2,8 mmol/L. Premir ⏻ para alterar com as setas ▲/▼, premir ⏻ para confirmar.

5. Premir ▲ para aceder ao ajustamento do valor de Hiperglucose, ficando *"Hyper"* a piscar; na entrega o valor de hiperglucose está definido para 2,8 mmol/L. Premir ⏻ para alterar com as setas ▲/▼, premir ⏻ para confirmar.

6. Premir ▲ para aceder ao alarme onde encontra um relógio a piscar no visor; premir em ⏻ para o alarme nº. 1 para ajustar o alarme nº. 1

18:30 OFF

7. Premir ⏻ para alterar com ▲ para definir o alarme como Ligado/Desligado
Se selecionar Ligado, o tempo deve ser ajustado para quando pretende que o alarme seja emitido e apresentado, premir ⏻ e usar ▲/▼ para ajustar a hora, e premir ⏻ para confirmar; 1 fica a piscar

18:30 On

8. Premir ▲ para aceder ao alarme 2 e repetir a partir do ponto 6.

Premir em ⏻ durante 2-3 segundos para desligar o medidor ou este desliga-se depois de 2 minutos.

Por favor consultar o manual de utilização que é entregue com o medidor para mais informações.

Contactar o Serviço de Clientes da MedCore pelo tel: 08-631 08 30 ou Info@medcore.se

Medcore Sweden AB, Finlandsgatan 62, Box 6065, SE - 164 06 Kista,
Tel: +46 (0)8 631 08 30, Fax: +46 (0)8 631 08 40, info@medcore.se, www.medcore.se